ТОО «SteriMed» (СтериМед).
РК, г. Алматы, ул. Шашкина 30А, кв.4
Тел: +7 7775497593, сот. +7 705 209 53 19. Эксклюзивный поставщик оборудования марки ТЗМОИ, DGM, Steelco, Famos на территории РК.
Авторизованный сервисный центр по обслуживанию оборудования ТЗМОИ, DGM, Steelco, Famos.
www.sterimed.kz
E-mail: sterimed@mail.ru.

16.04.2025

В Департамент внутреннего
государственного аудита
по г. Алматы

Жалоба

ТОО «SteriMed» (СтериМед)» приняло участие в конкурсе № объявления 14365569-1 Приобретение медицинских изделий. Наименование заказчика Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан"

1) По номерам лотов:

74041148-ОК3 Рулоны со складкой 150мм*50мм*100мм из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината

74041149-ОК3 Рулоны со складкой 200мм*55мм*100м из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината

74041169-ОК3 Бумажные пакеты белого цвета со складкой размер 140*75*250 мм

74041174-ОК3 Бумажные пакеты белого цвета со складкой размер 90*50*125 мм

К участию во втором этапе допущены 2 компании: Товарищество с ограниченной ответственностью "Heng Pan"(победитель), потенциальный поставщик, занявшим второе место ТОО «SteriMed» (СтериМед) ". ТОО "Heng Pan"(победитель) предоставили продукцию производителя Anqing Procter&Gamble; Packaging Co., Ltd, адрес: Улица Синье, дом 123, Район развития Аньцина, Провинция Аньхой, Китай.

В технической спецификации заказчика есть условие- Срок сохранения стерильности в упаковках после стерилизации в одинарной упаковке, при запечатывании с помощью термозапаивающего аппарата, должно составлять 2 лет, однако на сайте производителя **https://www.baojiechina.com/product/18.html** и https://www.baojiechina.com/product/16.html указан срок сохранения стерильности 6 месяцев и на рулоны и на пакеты.

麦迪帕克 BAJAYPACK

Дом Центр продуктов О компании P&G Новости | 0556-536941

并于灭菌后6个月内使用；

- Apply to hospital, clinic and laboratory's sterilization;and also apply to the disinfection of beauty products or family high-temperature;
- Apply to both ETO sterilization and STEAM sterilization;
- The sharp part of equipment should be put contrary to the peel side to ensure safety use;
- Using sealing machine to seal and mark the sterilization time,contents and usage etc.
- The clear area with temperature below 25℃ and humidity below 60% is recommended, the valid period will be 6 months after sterilizing

Аньцинская компания по упаковке Procter & Gamble Packaging Co., Ltd.

规格参数
SPECIFICATION

产品 ITEM	规格（款x长） SIZE(WxL)		包装 PACKING	外箱尺寸 SIZE OF CTN	毛重 G.W	净重 N.W
编号 NO.	英寸 INCH	SIZE	卷/箱 ROLL/CTN	长x宽x高 LxWxH（cm）	KG/箱 kg/CTN	KG/箱 kg/CTN
LTJD.075-100	3"	75±10mmx25mmx100m	8	40x21x32	10.0	9.5

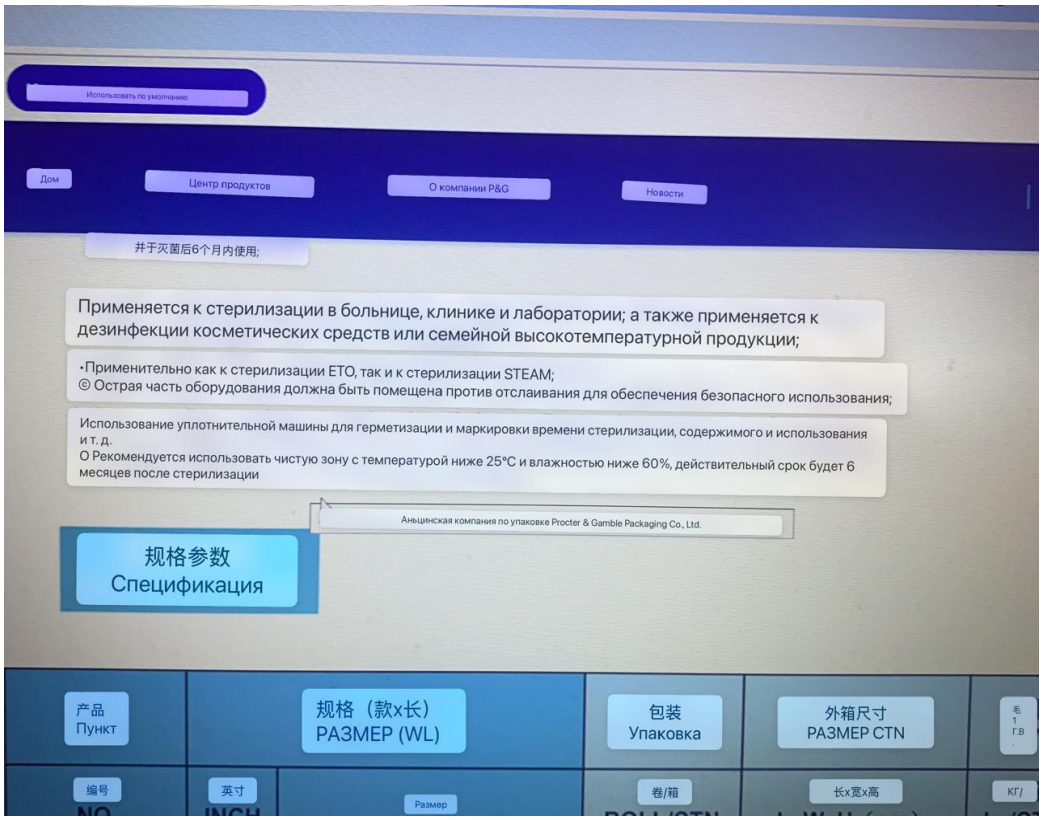

ТОО "Heng Pan"(победитель) предоставили недостоверные сведения, продукция производителя Anqing Procter&Gamble не соответствует требованиям технической спецификации.

Просим отменить итоги конкурса по данным лотам, отклонить заявки ТОО "Heng Pan" в связи с предоставлением недостоверных сведений, признать победителем ТОО «SteriMed» (СтериМед)».

2)По номерам лотов:

74041132-ОК3 Рулоны плоские 50мм*200м из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината
74041134-ОК3 Рулоны плоские 75мм*200м из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината
74041135-ОК3 Рулоны плоские 100мм*200м из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината
74041139-ОК3 Рулоны плоские 150мм*200м из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината
74041141-ОК3 Рулоны плоские 200мм*200м из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината
74041142-ОК3 Рулоны плоские 250мм*200м из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината
74041147-ОК3 Рулоны со складкой 100мм*50мм*100м из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината
74041151-ОК3 Рулоны со складкой 300мм*80мм*100м из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината
74041153-ОК3 Рулон плоский 75 мм х70 м
74041157-ОК3 Рулон плоский 150 мм х70 м
74041159-ОК3 Рулон плоский 200 мм х70 м
74041161-ОК3 Рулон плоский 250 мм х70 м

К участию во втором этапе допущены 2 компании: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Строй LTD" (победитель), потенциальный поставщик, занявшим второе место ТОО «SteriMed» (СтериМед) ".

Техническая спецификация победителя содержит следующие недостоверные сведения:

1. Неверно указана наименование продукции во всех лотах- Материал упаковочный стерилизационный. Модель: DGM. Марка: Steriguard.
   Верное наименование согласно РУ РК-МТ-7№014267 от 12.04.2022г.:
   74041132-ОК3 Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон плоский 50 мм х 200 м
   74041134-ОК3 Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон плоский 75 мм х 200 м
   74041135-ОК3 Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон плоский 100 мм х 200 м
   74041139-ОК3 Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон плоский 150 мм х 200 м
   74041141-ОК3 Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон плоский 200 мм х 200 м
   74041142-ОК3 Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон плоский 250 мм х 200 м
   74041147-ОК3 Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон со складкой 100 мм х 50 мм х 100 м
   74041151-ОК3 Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон со складкой 300 мм х 80 мм х 100 м
   74041153-ОК3 Материалы упаковочные в рулонах для медицинской плазменной стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 75 мм х 70 м
   74041157-ОК3 Материалы упаковочные в рулонах для медицинской плазменной стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 150 мм х 70 м
   74041159-ОК3 Материалы упаковочные в рулонах для медицинской плазменной стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 200 мм х 70 м
   74041161-ОК3 Материалы упаковочные в рулонах для медицинской плазменной стерилизации марки "DGM Steriguard": Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 200 мм х 70 м

2. Неверно указан производитель ООО "АльфаЛаб" адрес: 141402, г. Химки, Московской обл., ул. Союзная, д.7.
   Верное наименование производителя РУ РК-МТ-7№014267 от 12.04.2022г.: ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»
   Верный адрес производителя: 121353, г. Москва, шоссе Сколковское, д. 25 стр. 1 этаж 2 офис 34, согласно открытому источнику
   https://www.rusprofile.ru/id/4266541?ysclid=m9k1bxg5f5651952848

Просим отменить итоги конкурса по данным лотам, отклонить заявки ТОО "Аманат Строй LTD" в связи предоставлением недостоверных сведений, признать победителем ТОО «SteriMed» (СтериМед)».

Генеральный директор Кравченко М.В.