ТОО «SteriMed» (СтериМед).
РК, г. Алматы, ул. Шашкина 30А, кв.4
Тел: +7 7775497593, сот. +7 705 209 53 19. Эксклюзивный поставщик оборудования марки ТЗМОИ, DGM, Steelco, Famos на территории РК.
Авторизованный сервисный центр по обслуживанию оборудования ТЗМОИ, DGM, Steelco, Famos.
www.sterimed.kz
E-mail: sterimed@mail.ru.

13.05.2025
Исх. №22

Кому:
Государственное учреждение
"Управление государственных
закупок акимата Костанайской
области" Республика Казахстан,
город Костанай, улица Касымканова, 34
От кого:
ТОО «SteriMed» (СтериМед).
РК, г. Алматы, ул. Шашкина 30А, кв.4

Открытый конкурс № 14571967-1,
Лот № 78586994-ОК1 «Установка
для обеззараживания медицинских
отходов с Шредером для измельчения
обеззараженных медицинских отходов».

Жалоба

ТОО «SteriMed» (СтериМед)» приняло участие в конкурсе № 14571967-1, Лот № 78586994-ОК1 «Установка для обеззараживания медицинских отходов с Шредером для измельчения обеззараженных медицинских отходов». К участию допущены 3 компании: ТОО "Grand Service Kazakhstan" (победитель), потенциальный поставщик, занявшим второе место ТОО "TrioSynergy" и ИП BASSP. ТОО «SteriMed» (СтериМед) отклонен.

Мы не согласны с протоколом итогов, а именно:

1.Отклонение заявки ТОО «SteriMed» (СтериМед):

Эксперты: КОЧКУРОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, Председатель, ШАЙГУЗОВА СЫМБАТ КАЖИГАЛИЕВНА, Член комиссии, ПАНОВА АЛЬБИНА РАДИКОВНА, Член комиссии

Причина: Не соответствие конкурсной документации

Описание: В соответствии с подпунктом 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: 1. В разделе «наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» не указан требуемый национальный стандарт СТ РК 3822-2022; 2. В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не указаны требуемые характеристики закупаемого товара, а именно: Материал наружных панелей должен быть -нержавеющая сталь (металлический сплав, основу которого составляет железо (Fe), его содержание должно быть не менее 61.4%. Обязательно в сплаве присутствуют хром, никель, молибден, марганец. Коррозионно-стойкая аустенитная сталь, обладающая высокой жаростойкостью и устойчивостью к агрессивным средам. ГОСТ 5632-72); Материал водопаровой камеры должен быть -нержавеющая сталь (металлический сплав, основу которого составляет железо (Fe), его содержание должно быть не менее 61.4%. Обязательно в сплаве присутствуют хром, никель, молибден, марганец. Коррозионно-стойкая аустенитная сталь, обладающая высокой жаростойкостью и устойчивостью к агрессивным средам ГОСТ 5632-72); Материал крышки камеры должен быть -нержавеющая сталь (металлический сплав, основу которого составляет железо (Fe), его содержание должно быть не менее 61.4%. Обязательно в сплаве присутствуют хром, никель, молибден, марганец. Коррозионно-стойкая аустенитная сталь, обладающая высокой жаростойкостью и устойчивостью к агрессивным средам ГОСТ 5632-72);

1)В связи с тем, что производителем оборудования «Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-75 с шредером DGM ZZ-S для измельчения обеззараженных медицинских отходов» является зарубежный производитель, не представляется возможным указать СТ РК 3822-2022. Производитель установки является Российская Федерация, ТОО «SteriMed» (СтериМед) указало международный стандарт ISO 13485, который действует на заводе ТЗМОИ и является **международным.** В форме ТС Заказчика допускается указание международных стандартов.

2) Нержавеющая сталь (металлический сплав, основу которого составляет железо (Fe), его содержание должно быть не менее 61.4%. Обязательно в сплаве присутствуют хром, никель, молибден, марганец. Коррозионно-стойкая аустенитная сталь, обладающая высокой жаростойкостью и устойчивостью к агрессивным средам. ГОСТ 5632-72)-**это состав стали марки AISI 31603 (03Х17Н14М3), что нами и указано в нашей ТС.**

В связи с вышеизложенным, считаем, что отклонение заявки ТОО «SteriMed» (СтериМед)» было не обоснованным. Просим пересмотреть протокол итогов и допустить к участию ТОО «SteriMed» (СтериМед)».

2.**ТОО "Grand Service Kazakhstan"** (победитель) предоставил недостоверные сведения. На сайте производителя Jiangsu Rooe Medical Technology Co., Ltd.(Джиангсу Рое Медикал Ко.Лтд) на представленное оборудование «Установка для обработки материалов Марка JRL Модель MCDS-80», указаны совершенно иные ТХ, нежели в заявке ТОО "Grand Service Kazakhstan" (победитель). Ниже приведены сканы со страниц сайта завода производителя. Модель MCDS-80 имеет принципиально другую конструкцию-шредер встроен в установку, а не является комплектующим и стоящим отдельно, как в ТС Заказчика. Габариты, вес, литраж оборудования не соответствуют.

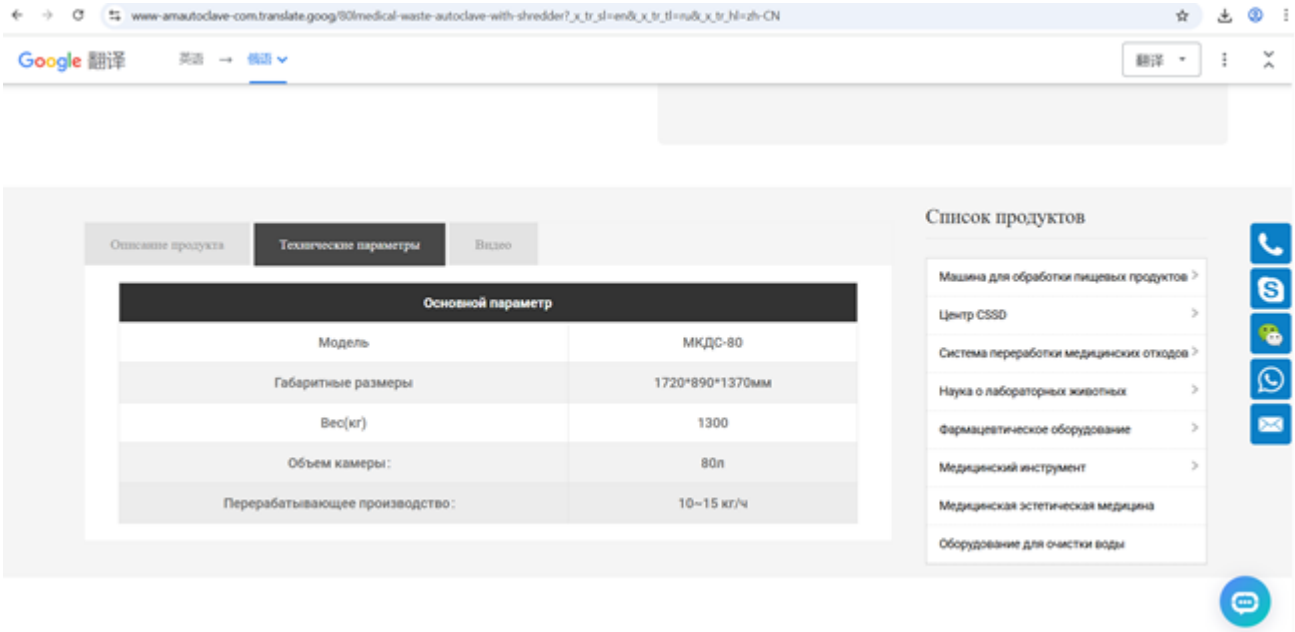

Ссылка на сайт: https://www-amautoclave-com.translate.goog/80lmedical-waste-autoclave-with-shredder?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=zh-CN

Считаем, что конкурсная комиссия не внимательно рассмотрела заявку ТОО "Grand Service Kazakhstan" (победитель). Просим пересмотреть протокол и отстранить от участия ТОО "Grand Service Kazakhstan" (победитель) за предоставление недостоверной информации.

3. ТОО "TrioSynergy" предоставило недостоверную информацию. Не верно указано наименование оборудования «Установка для обработки материалов (обеззараживания медицинских отходов предназначены для децентрализованной обработки в стационарных лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов классов «Б» и «В») ВК-75-01». Обращаем внимание на то, что модель ВК-75-01производства ТЗМОИ Россия, является стерилизатором паровым в комплекте, который зарегистрирован в Республике Казахстан **РУ № 001202.**
Доказательство:

register.ndda.kz/category/search_prep

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

қаз | рус | eng

Главная » Государственный реестр » Поиск препаратов

№ РК-МТ-7№001202

Основные данные | Приказы | Производитель | Комплектность МИ | Варианты исполнения | Инструкции | Сертификаты | Упаковка

Тип	МИ	**Вид регистрации**	Перерегистрация
Дата регистрации	03.07.2020	**Срок регистрации**	
Дата истечения	Бессрочный	**Срок хранения**	10 г.
Рег.номер каз	ҚР-МТ-7№001202		
Торговое название	Стерилизатор паровой ВК-75-01 в комплекте		
Торговое название каз	ВК-75-01 бу стерилизаторы жиынтықта		
Назначение	Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, воздействие пара на ко-торые не вызывает изме-нения их функциональных свойств.		
Область применения	Медицинские учреждения, центрально-стерилизационные отделения		
Класс безопасности	Класс 2 а – со средней степенью риска		
Краткая техническая характеристика	восстановлены). в) Экономическая нецелесообразность восстановления стерилизатора, т. е. когда изделие подлежа! списанию, когда затраты на ремонт резко растут и составляют в год более 60% первоначальной стоимость стерилизатора.		

Мы, компания ТОО «SteriMed» (СтериМед)» являемся уполномоченными представителями производителя на территории РК, что указано в данном РУ.
Мы так же являемся эксклюзивными представителями завода ТЗМОИ на территории Республики Казахстан и заявляем, что «Установка для обработки материалов (обеззараживания медицинских отходов предназначены для децентрализованной обработки в стационарных лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов классов «Б» и «В») ВК-75-01» заводом ТЗМОИ не производится. Завод ТЗМОИ производит Установку для обеззараживания медицинских отходов СМО-75, данная установка может комплектоваться шредерами, в том числе и шредером DGM ZZ-S для измельчения обеззараженных медицинских отходов.
Доказательство:

phs-mt.ru/products/oborudovanie-dlya-utilizatsii-meditsinskikh-otkhodov/ustanovki-dlya-utilizatsii-meditsinskikh-otkhodov/ustanovka-dlya-obezzarazhivaniya-meditsinskikh-... Перезапустить и обновить

phs Фармстандарт–Медтехника
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Отдел продаж 8 (495) 256-29-14 Техническая поддержка 8 (800) 707-91-62 Заказать звонок

О компании Продукция Услуги Наши проекты Отзывы Контакты RU EN

Главная → Продукция → Оборудование для утилизации медицинских отходов → Установки для утилизации медицинских отходов →
Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-75

ТЗМОИ

Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-75

Установки для обеззараживания медицинских отходов СМО-75 предназначены для децентрализованной обработки в стационарных лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов классов «Б» и «В» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21

Сделать заказ ⟶

Сравнить

Так же, ТОО "TrioSynergy" не верно указал адрес завода Ленинского района г. Тюмень.
Верный адрес завода АО ТЗМОИ: Россия 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5, ЭТ 1

Доказательство:ссылка на сайт https://phs-mt.ru
Считаем, что конкурсная комиссия не внимательно рассмотрела заявку ТОО "TrioSynergy"Kazakhstan". Просим пересмотреть протокол и отстранить от участия ТОО "TrioSynergy" за предоставление недостоверной информации.

Генеральный директор Кравченко М.В.