Реквизиты:
БИН 120 940 002 382
IBAN KZ13 998B TB00 0035 7782
Банк АО «Цесна банк»
БИК TSESKZKA

Адрес:
г. Астана
Пр. Б. Момышулы 6/1 - 63
г. Астана – 010000
Республика Казахстан

Контакты:
Тел/факс +7 (7172) 684 517
Email: ads_sapa@mail.ru
Моб: +7 776 880 00 60
+7 702 777 31 01
+7 775 567 88 99

исх: MSM/082

Дата: воскресенье, 11 марта 2018 г.

Департамент внутреннего
государственного аудита по городу Астана
Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Настоящим ТОО «АДС САПА» пользуясь случаем выражает Вам уважение и почтение, позвольте пожелать Вам дальнейших успехов в делах.

Мы ознакомились с доводами ТОО «КЦУП» за их исх. №284-КЦУП от 07.09.2018 года по конкурсу 2256964-2 проведенной Управлением топливно-энергетическим компексом и и коммунального хозяйства г. Астана, где мы участвуем в составе консорциума с ТОО D&J Emporio, и решили пояснить следующее:

По доводам ТОО «КЦУП»:

Согласно пункту 2 статьи 11 Закона о государственных закупок от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК:
2. Достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок.

В своих доводах ТОО «КЦУП» ссылается на Государственный стандарт РК «Порядок признания результатов первичной поверки (калибровки) средств измерений, проводимой зарубежными метрологическими организациями». Так вот согласно официальному разъяснению от РГП «КазИнМетр» (согласно пункту 1 постановления правительства РК от 01.11.1996 г. №1342 является государственным предприятием и государственным научным метрологическим центром) на их сайте (ссылка: https://kazinmetr.kz/services/pppsipzms/)

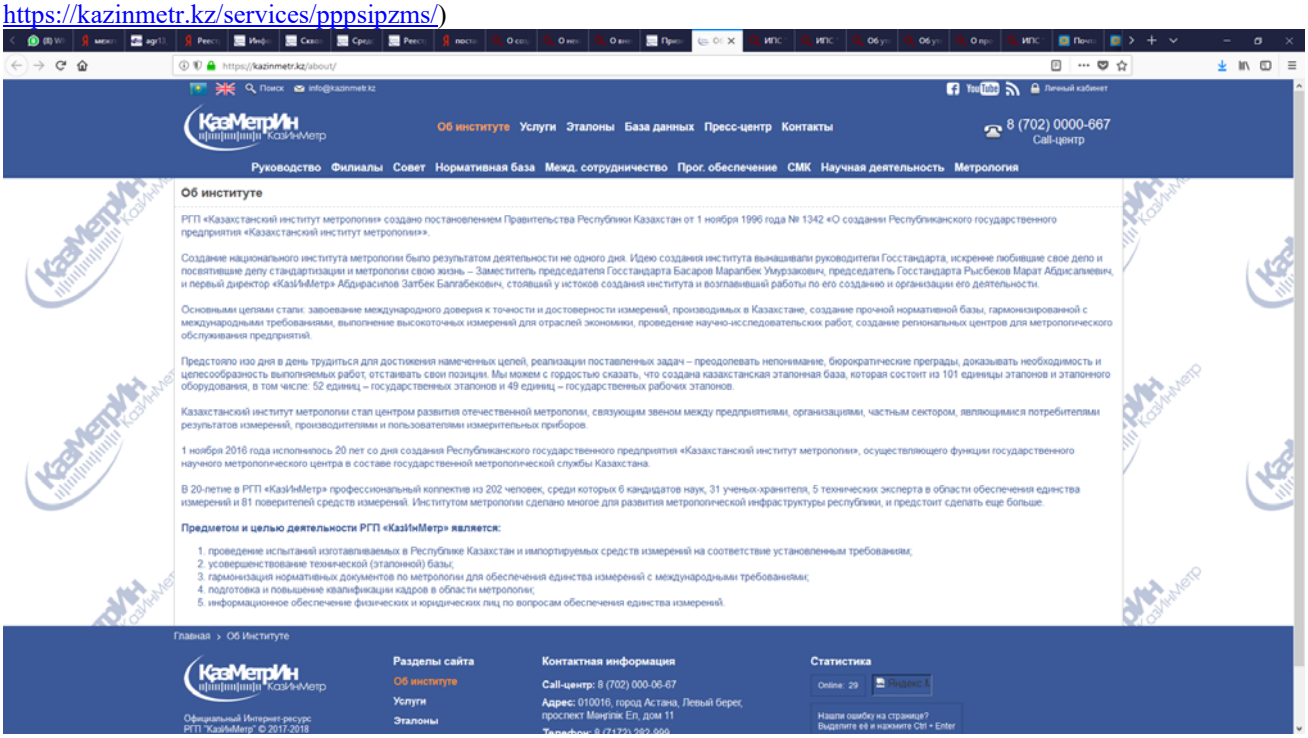

Для признания первичной поверки (калибровки) средств измерений, в соответствии с требованиями СТ РК 2.40-2002, заявитель представляет в государственный научный метрологический центр уполномоченного органа комплект документов, включающий:

В случае, если лаборатория аккредитована на соответствие требованиям ИСО/МЭК 17025 и орган по аккредитации, аккредитовавший лабораторию является подписантом «Соглашения о взаимном признании результатов испытаний и калибровки, полученных в лабораториях разных стран» допускается признать результаты первичной поверки (калибровки) средств измерений на основании представленных с переводами на государственный и/или русский языки и заверенные нотариально следующих документов:

- аттестата (свидетельства, сертификата) об аккредитации;
- области аккредитации и образца сертификата о поверке (калибровке) признаваемых типов средств измерений».

Результаты проверки технической компетентности метрологической службы зарубежной фирмы оформляются экспертным заключением на представленный комплект документов проверки технической компетентности поверочной (калибровочной) лаборатории по проведению первичной поверки (калибровки) средств измерений.

При положительном решении метрологическая служба зарубежной фирмы вносится в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и данная информация доводится до сведения заявителя.

Таким образом ТОО «КЦУП» согласно этому стандарту должно было представить **в государственный научный метрологический центр уполномоченного органа пакет документов согласно стандарту, и получить положительный решение. В конкурсной заявке, данного положительного решения нет, более того мы не нашли ссылку на Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан о действительности.**

Так же согласно пункту 3 статьи 9 Закона РК О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц от 12 января 2007 года № 221-III, по результатам обращения должны были быть приниматься решения:

3. По результатам рассмотрения обращений принимается одно из следующих решений:
1) о полном или частичном удовлетворении обращения;
2) об отказе в удовлетворении обращения с обоснованием принятия такого решения;
3) о даче разъяснения по существу обращения;
4) о прекращении рассмотрения обращения.

Те же доводы, которые были изложены ТОО «КЦУП» следует воспринимать как руководство какой путь должна пройти компания для признания сертификата Российского образца, в ином случае мы руководствуемся законодательством Республики Казахстан. Согласно которому, на территории Казахстана действуют сертификаты о поверок (калибровок) казахстанского образца, и приборы, не прошедшие поверку не допускаются к эксплуатации.

Согласно закону «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года N 53-II3

Глава 4. Утверждение типа, производство, ремонт, поверка и калибровка средств измерений

Статья 17. Утверждение типа и метрологическая аттестация средств измерений

1. Средства измерений, производимые серийно в Республике Казахстан или ввезенные на территорию Республики Казахстан партиями и предназначенные для применения в сфере государственного метрологического контроля, перед вводом в эксплуатацию подлежат испытаниям с последующим утверждением типа этих средств измерений. Решение об утверждении типа средств измерений принимается уполномоченным органом и удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств измерений установленного образца, срок действия которого устанавливается при его выдаче.

6. Запрещаются выпуск в обращение, ввод в эксплуатацию, применение, реализация и реклама средств измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю, не прошедших испытания для целей утверждения типа или метрологическую аттестацию.

Реквизиты:
БИН 120 940 002 382
IBAN KZ13 998B TB00 0035 7782
Банк АО «Цесна банк»
БИК TSESKZKA

Адрес:
г. Астана
Пр. Б. Момышулы 6/1 - 63
г. Астана – 010000
Республика Казахстан

Контакты:
Тел/факс +7 (7172) 684 517
Email: ads_sapa@mail.ru
Моб: +7 776 880 00 60
+7 702 777 31 01
+7 775 567 88 99

На основании вышеизложенного просим отклонить доводы ТОО «КЦУП», признать доводы заказчика правомерными в отношении ТОО «КЦУП»

С уважением,
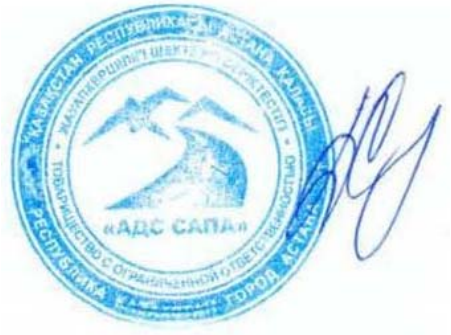
Диана Садыкова
Директор